


PATRÓN DE REFERENCIA: **BLOQUE DE DUREZA HRBW**

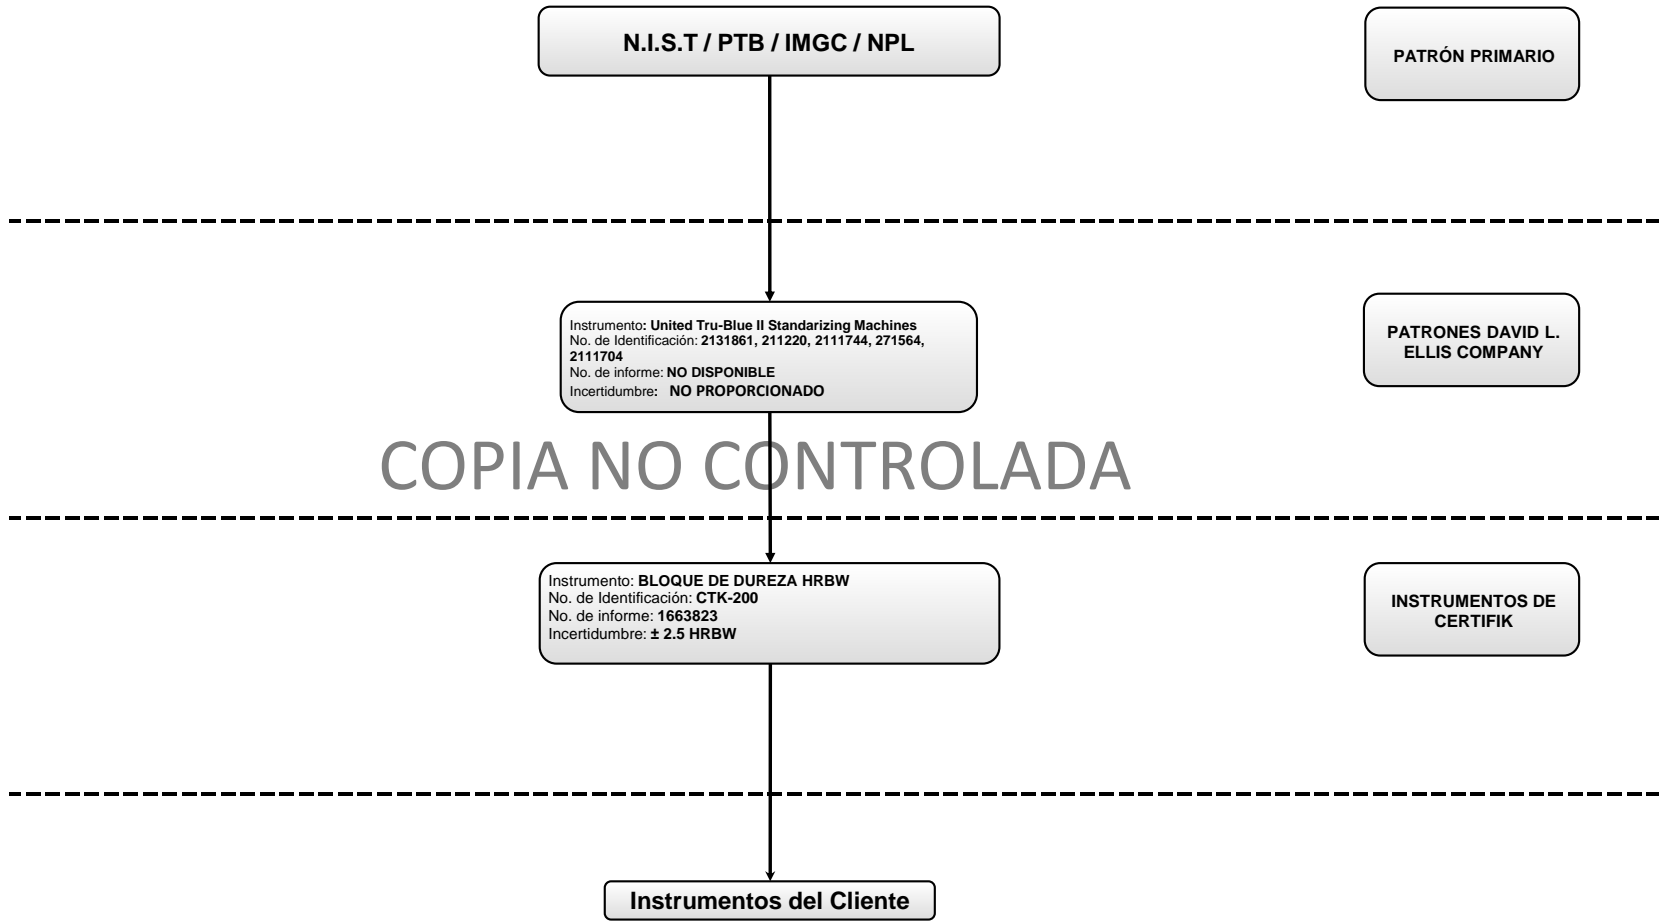

N.I.S.T / PTB / IMGC / NPL

PATRÓN PRIMARIO

Instrumento: United Tru-Blue II Standardizing Machines  
 No. de Identificación: 2131861, 211220, 2111744, 271564, 2111704  
 No. de informe: NO DISPONIBLE  
 Incertidumbre: NO PROPORCIONADO

PATRONES DAVID L. ELLIS COMPANY

Instrumento: BLOQUE DE DUREZA HRBW  
 No. de Identificación: CTK-200  
 No. de informe: 1663823  
 Incertidumbre: ± 2.5 HRBW

INSTRUMENTOS DE CERTIFIK

Instrumentos del Cliente