


PATRÓN DE REFERENCIA: MULTIMETRO 4 1/2 DIGITOS

PATRÓN PRIMARIO NACIONAL DE ELECTRICIA

Patrón primario
CENAM

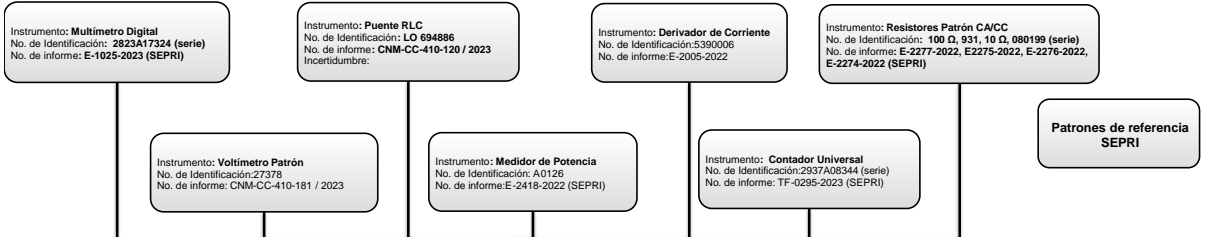

Instrumento: CALIBRADOR MULTIFUNCIONES
 No. de Identificación: CTK-396
 No. de informe: E-1692-2023, E-1687-2023, TF-1045-2023
 Incertidumbre: IKLH
 $\pm 6,6$ a $6,9$ mV/V @ $1\ 000$ V Tensión eléctrica continua, $\pm 0,010\ %L$ @ 20 A
 Corriente eléctrica continua, $\pm 0,0092\ %L$ @ $1\ 000$ V @ 8 kHz Tensión eléctrica alterna, $\pm 0,020\ %L$ @ 20 A @ 1 kHz Corriente eléctrica alterna, $\pm 0,23\ %L$ @ $1\ 000$ MΩ Resistencia, ± 10 a 37 μV/V @ $1\ 000$ V @ $10\ 000$ °C
 Generación de temperatura
 Fecha de vencimiento: 2024-SEP-22

Patrones de referencia
CERTIFIK

Instrumento: Multímetro 4 1/2 Dígitos
 No. de Identificación: CTK-346
 Marca: Fluke
 Modelo: 289
 Serie: 29990120
 No. de informe: EL-085823-1
 Incertidumbre: Tensión eléctrica alterna $\pm 0,000\ 73$ V, Tensión eléctrica continua $\pm 0,000\ 082$ V, Resistencia eléctrica (a la corriente continua) $\pm 0,000\ 068$ kΩ, Corriente eléctrica alterna $\pm 0,002\ 7$ A, Corriente eléctrica continua $\pm 0,000\ 46$ A
 Vigencia: 2025-03-07

Instrumentos de
CERTIFIK

Instrumentos del Cliente